

การให้คำปรึกษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในกรณีมีปัญหาการไหลของน้ำยา  
ก. น้ำยาไม่ไหลเข้า (ในกรณีที่ใช้ยี่ห้อ แบกเตอร์)

ให้แนะนำผู้ป่วยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ผู้ป่วยตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติในขั้นตอนดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว คือ
  - 1.1 หักแกนเขียว
  - 1.2 เปิดตัวหนีบ
  - 1.3 เปิดวาล์ว
  - 1.4 สายไม่มีการหักพับงอ
2. ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตามข้อ 1 ครบแล้วน้ำยายังไม่ไหลเข้า ให้บีบไล่สายน้ำยาและสายต่อ
3. ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตามข้อ 2 ครบแล้วน้ำยายังไม่ไหลเข้า ให้ขยับตัวไปมา ลุกนั่ง ลุกเดิน ประมาณ 5 นาที
4. ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตามข้อ 3 ครบแล้วน้ำยายังไม่ไหลเข้า ให้ติดต่อหน่วยล้างไตทางช่องท้องที่ผู้ป่วยรักษา

ข. น้ำยาไม่ไหลออก (ในกรณีที่ใช้ยี่ห้อ แบกเตอร์)


ให้แนะนำผู้ป่วยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ผู้ป่วยตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติในขั้นตอนดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว คือ
  - 1.1 หักแกนเขียว
  - 1.2 เปิดตัวหนีบ
  - 1.3 เปิดวาล์ว
  - 1.4 สายไม่มีการหักพับงอ
2. ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตามข้อ 1 ครบแล้วน้ำยายังไม่ไหลออก ให้บีบไล่สายน้ำยาและสายต่อ
3. ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตามข้อ 2 ครบแล้วน้ำยายังไม่ไหลออก ให้ขยับตัวไปมา ลุกนั่ง ลุกเดิน ประมาณ 5 นาที
4. ถ้าทำข้อ 3 ครบแล้วยังไม่ไหลออก ให้ปิดจุก และรับประทานยาระบาย และติดต่อหน่วยล้างไตทางช่องท้องที่ผู้ป่วยรักษา

### ค. น้ำยาฆ่าเชื้อ (ในกรณีที่ใช้ยี่ห้อเฟรซิเนียส)

ให้แนะนำผู้ป่วยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ผู้ป่วยตรวจสอบว่าได้เปิดตัวหนีบที่ตัวผู้ป่วยแล้ว
2. ให้ผู้ป่วยตรวจสอบว่าปลายลูกศรอยู่ตรงกับจุดที่บสีน้ำเงิน ตามรูปจุดที่ลูกศรชี้

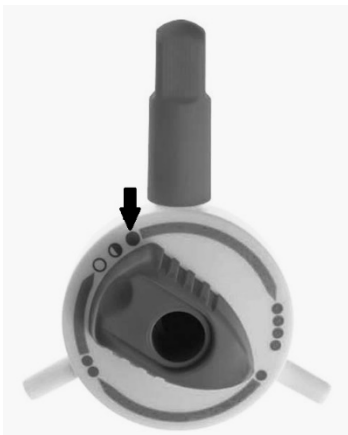


3. ถ้าน้ำยายังไม่ไหลเข้าให้ดึงแป้นหมุน ออกจากแป้นยึด แล้วเคาะเบาๆประมาณ 10 ครั้ง
4. ถ้าน้ำยายังไม่ไหลเข้า ให้ขยับตัวไปมา ลุกนั่ง ลุกเดิน ประมาณ 5 นาที หรือหายใจบนจักรยานในอากาศ
5. ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตามข้อ 4 ครบแล้วน้ำยายังไม่ไหลเข้า ให้ติดต่อหน่วยล้างไตทางช่องท้องที่ผู้ป่วยรักษา

### ง. น้ำยาฆ่าเชื้อ (ในกรณีที่ใช้ยี่ห้อ เฟรซิเนียส)

ให้แนะนำผู้ป่วยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ผู้ป่วยตรวจสอบว่าได้ต่อสายล้างไตเข้ากับจานหมุนเรียบร้อยแล้ว
2. ให้ผู้ป่วยตรวจสอบว่า ปลายลูกศรอยู่ตรงกับจุดปล่อยน้ำยา ตามรูปจุดที่ลูกศรชี้

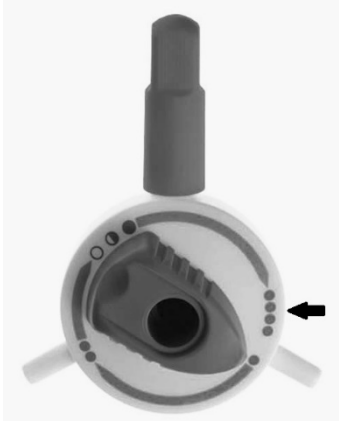

3. ให้ผู้ป่วยตรวจสอบว่าได้เปิดตัวหนีบ(Clamp)ที่ผู้ป่วยเรียบร้อย
4. ถ้าน้ำยาไม่ไหลออกให้ดึงแป้นหมุน ออกจากแป้นยึดเคาะเบาๆประมาณ 10 ครั้งตรวจสอบการไหลอีกครั้ง
5. ถ้าน้ำยาไม่ไหลออกให้ขยับตัวไปมา ลุกนั่งและ ลุกเดิน ประมาณ 5 นาที
6. ถ้าทำข้อ 5 ครบแล้วยังน้ำยายังไม่ไหลออก ให้ปิดจุก และรับประทานยาระบาย และ ติดต่อหน่วยล้างไตทางช่องท้องที่ผู้ป่วยรักษา